各位

平成２１年１０月
株式会社モリトー

弊社製品による転落事故（重大事故）について

発生日　　2009年8月２８日

該当製品　介護リフトつるべーBセット
製造期間　1998年9月から11月
販売期間　1998年10月から1999年3月

発生の経緯　ベッドから車椅子への移乗時に、アームとモーターが外れ、床に落下。

発生の原因　アームとモーターの接合部の接合が不完全であったと思われますが、
詳細につきましては現在調査中です。

現在ご利用中の方へ

再度取扱説明書ならびに使用前の接合状況の安全確認をお願い致します。
部品に変形等が見られる場合には、ただちに使用を中止して頂き、弊社
もしくは取扱店にご連絡して頂きますよう、お願い申し上げます。

■製品を安全に使用して頂くために

介護リフトつるべーを安全にご使用して頂くための使用方法ならびに注意事項を、製品に添付しております取扱説明書に記載し、ご利用者様にお知らせしておりますが、取扱説明書内に記載されております警告ならびに注意を確認せずに使用された場合、死亡事故を含む重大な事故に至る可能性がございます。介護リフトつるべーをご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読み頂き、正しく安全な使用方法をご理解下さい。

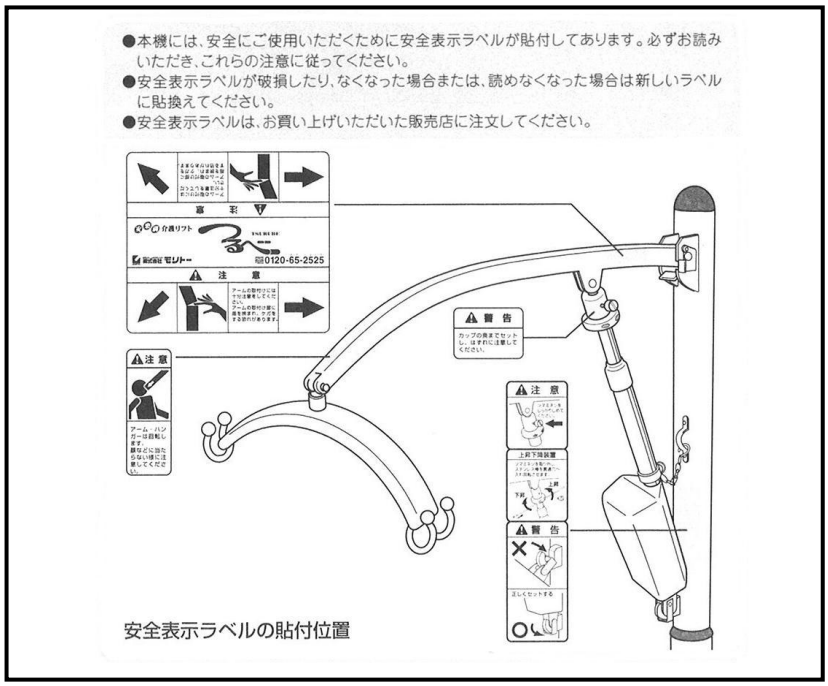

■特に守って頂きたいこと。

介護リフトつるべーをご使用される際には、次の事項を必ずお守り下さい。

ご使用時に次の事項を守られない場合、落下等の事故につながり、ご利用者様がケガをし、場合によっては死亡に恐れがありますので、十分ご注意下さい。

詳しくは取扱説明書をご覧下さい。

①アームがアーム取付け部にしっかり取付けられているか確認して下さい。

②アームが安全フックでロックされていることを確認して下さい。

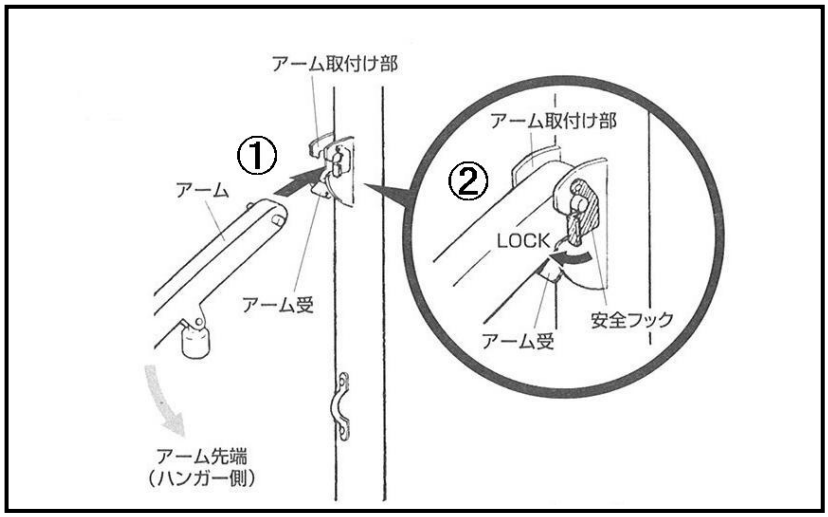

①モーター下部のＵリングを起こし、モーター受けにしっかりと取付けて下さい。
②Ｕリングを下に戻して下さい。
③安全チェーンを掛けて下さい。

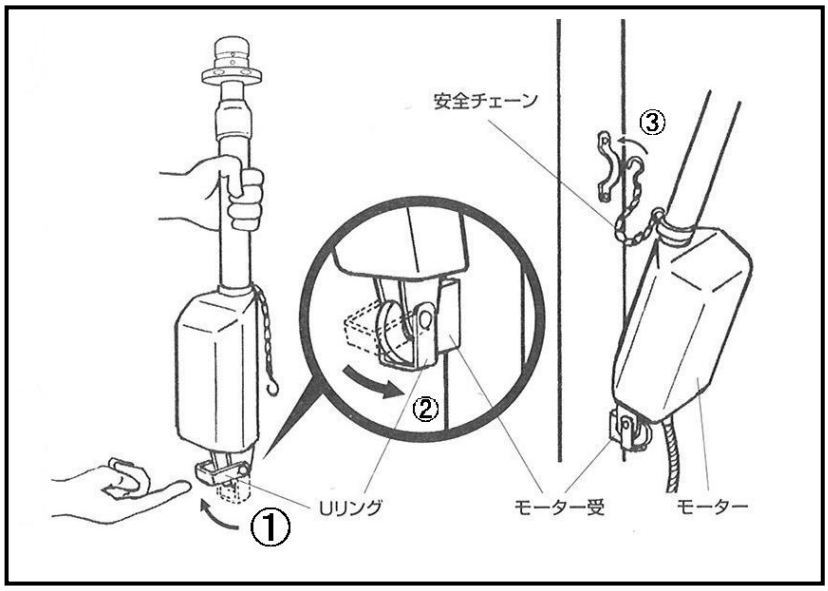

アームとモーターの接合時に、モーターキャップが確実にアームカップに差込まれているか確認して下さい。ツマミネジのある物はツマミネジを奥までしっかり締めて下さい。**円中のように、斜めに差込まれないように特にご注意下さい。**